
Duo Tandem / Quattro Tandem

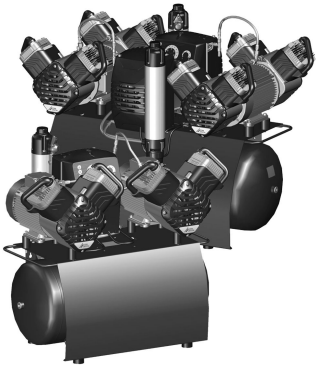


www.duerrdental.com
Best.-Nr: 4252100034

+10°C +40°C Umgebungstemperatur

95 % Obere Feuchtigkeitsbegrenzung

Nur ausgebildete Fachkräfte oder von Dürr Dental geschultes Personal dürfen das Gerät aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen.

Bedienfeld

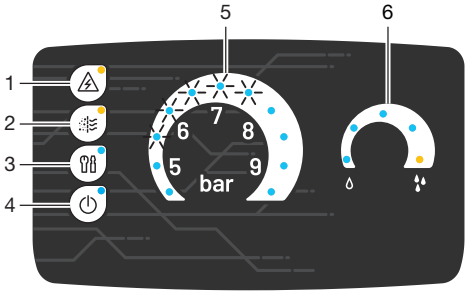

1 Störungs-Taste mit LED
2 Filterwechsel-Taste mit LED
3 Service-Taste mit LED
4 Standby-Taste mit LED
5 Druckbereich Anzeige / Einstellung
6 Drucktaupunkt Anzeige


Gerät einschalten

1




Auffangschale entleeren

1



24. Stunde / hour

2

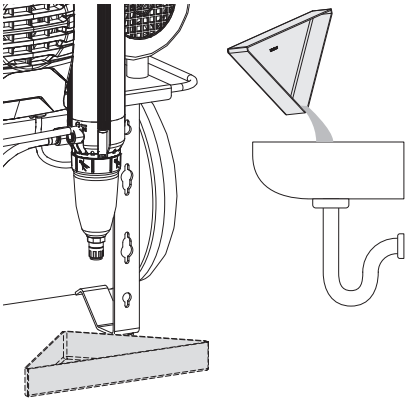

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen,
Germany

4252100053L40

2105V002

Filter wechseln


1




2




3




4




5




6

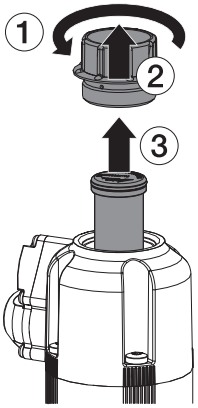

7

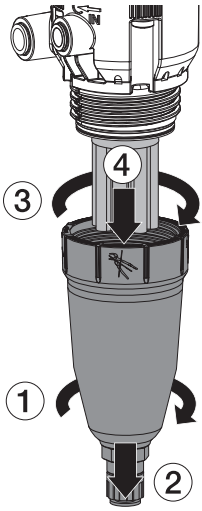


8



9



10



11



12



13

